

近隣住民の皆様

松江生協病院
院長 眞木 高之

MRI 装置更新作業に伴うお知らせとお願い

拝啓

平素は当院の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、当院におきまして下記日程にて MRI 装置の更新作業を実施いたします。

作業にあたっては細心の注意を払い、安全第一で取り組んでまいります。作業の特性上、万が一の事態に備え、近隣の皆様へ事前のご案内をさせていただきます。

敬具

記

1. 作業日時

2026 年 9 月 3 日（木） 9 : 00～17 : 00

2. 作業内容

既存 MRI の消磁作業

作業中、極めて稀ではございますが、外部クエンチ配管（排出口）より気化したヘリウムが外部に放出される可能性があります。放出の際は、一時的に爆発音が発生いたします。その後、20 分程度白い煙が放出されます。

3. 安全性について

放出される白い煙は、無害で火災による煙ではございませんのでご安心ください。

消防署および関係機関へは、あらかじめ本作業および現象について届出・連携を行っております。

4. 皆様へのお願い

万が一、大きな音や白煙を目撃された場合でも、火災等ではございませんのでご安心ください。何かご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。


作業期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

【本件に関する問い合わせ先】

松江生協病院
担当：事務長室 広田律子
電話番号：0852-23-1111

以上

外部放出口

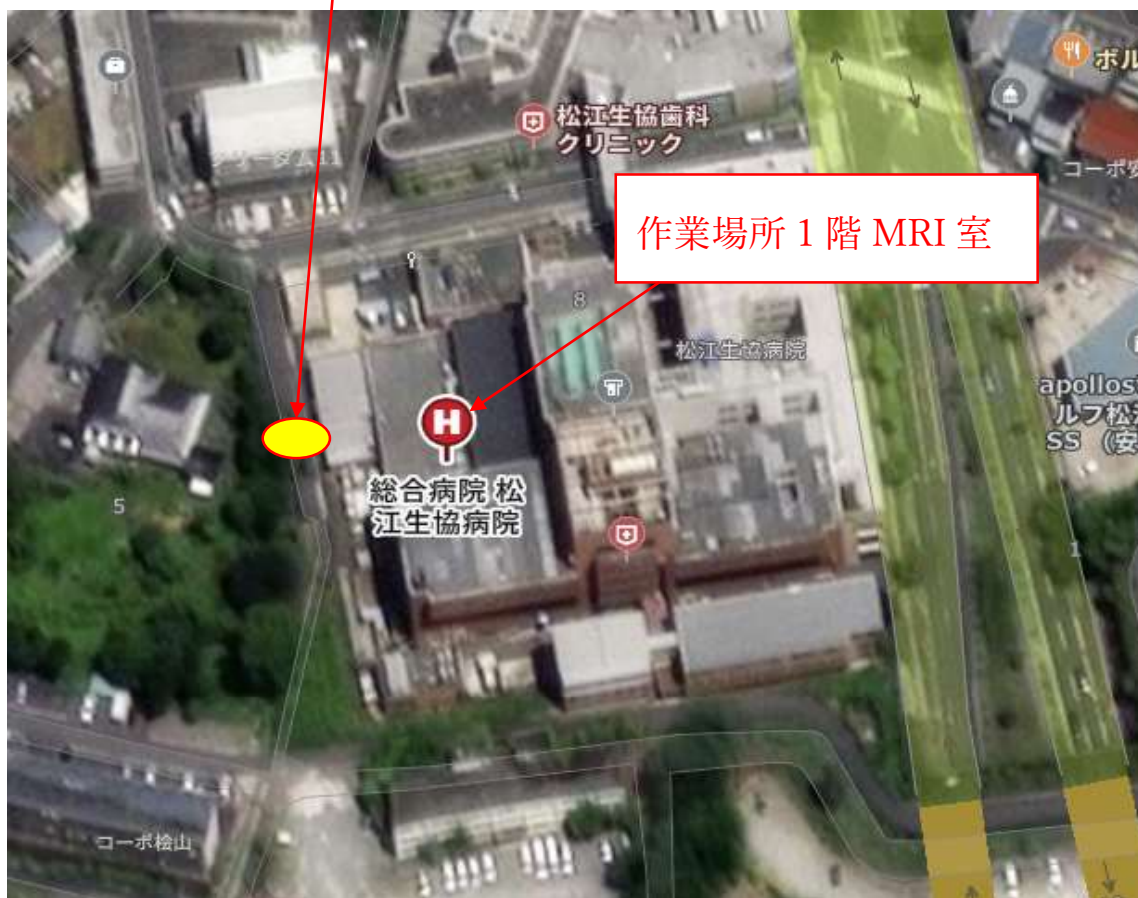

外部放出口

